

Foire aux questions (FAQ)

Puis-je subir un examen d'IRM?

Oui. Toutefois, il faut le faire à l'HGK du CSSK, à moins que vous changiez de fournisseur de soins.

Les appareils ménagers posent-ils un danger?

Non. Les appareils ménagers ordinaires ne posent pas de danger. Il faut en général rester à une distance d'un pied à une longueur de bras d'une cuisinière à induction. Il est recommandé de ne pas acheter de cuisinière à induction.

Les outils électriques posent-ils un danger?

Les outils électriques en bon état sont sans danger. L'utilisation d'une scie mécanique à gaz ou d'une soudeuse à l'arc est déconseillée.

Puis-je utiliser mon téléphone cellulaire ou ma tablette en toute sécurité?

Oui. Toutefois, ne gardez pas l'appareil dans une poche près de votre dispositif et essayez d'utiliser l'oreille du côté opposé lorsque vous parlez au téléphone.

Puis-je voyager?

Oui. Assurez-vous d'avoir votre carte de porteur d'appareil. Montrez-la au personnel de la sécurité à l'aéroport.

Quelle est la durée de vie de la pile?

La pile d'un DAI dure en moyenne de 5 à 7 ans.

La pile d'un DRC-S ou d'un DRC-D dure en moyenne de 4 à 6 ans.

Est-ce que le dispositif peut mal fonctionner?

Il est très rare qu'un dispositif fonctionne mal.

Conduite automobile

- Ne conduisez pas pendant une semaine après l'implantation d'un nouveau stimulateur cardiaque et de nouvelles sondes. Il n'y a pas de restrictions dans le cas d'un simple remplacement du stimulateur cardiaque. Toutefois, vous ne devriez pas conduire dans les 24 heures suivant une intervention.

Activation de l'enregistrement des symptômes

Enregistreur en boucle seulement

- Utilisez le bouton permettant d'activer l'enregistrement seulement lorsque vous ressentez le symptôme pour lequel le dispositif a été implanté.

Carte de porteur d'appareil

- Après l'implantation, vous recevrez une carte temporaire renfermant les renseignements sur votre appareil.
- Le fabricant vous enverra une carte officielle par la poste d'ici quelques mois.
- Gardez cette carte dans votre portefeuille ou votre sac à main, tout comme votre carte Santé.

Pour nous joindre

Centre des sciences de la santé de Kingston
76, rue Stuart, Kingston (Ontario)
Service de gestion du rythme cardiaque
Fraser Armstrong, 3e étage
Sans frais : 1 800 567-5722
Local : 613 549-6666, poste 4547
KingstonHSC.ca

**Kingston Health
Sciences Centre**

Centre des sciences de
la santé de Kingston

Also available in English.

Rév. : décembre 2023, version 1


L'illustration sur la page couverture provient de la Boston
Scientific Corporation, qui en a autorisé l'utilisation.
Tous droits réservés.
© 2014 Boston Scientific Corporation.

**Kingston Health
Sciences Centre**

Centre des sciences de
la santé de Kingston

Guide de soins à domicile pour dispositif cardiaque


Stimulateur cardiaque Enregistreur en boucle implantable

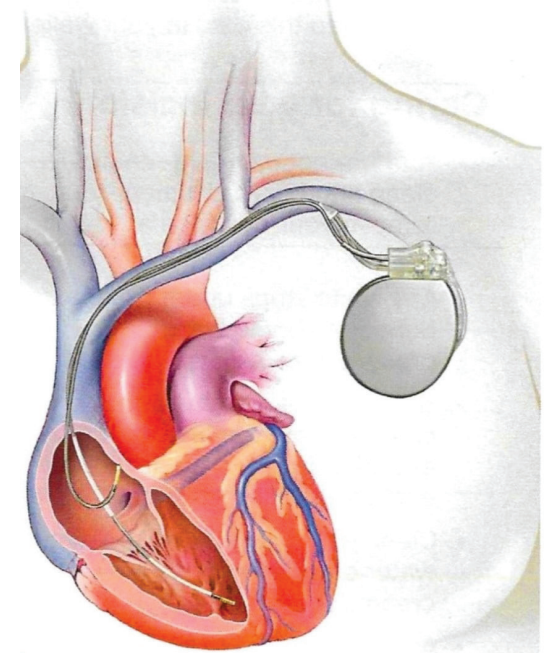

Hôpital
Hôtel Dieu
Hospital



Hôpital Général de
Kingston General
Hospital

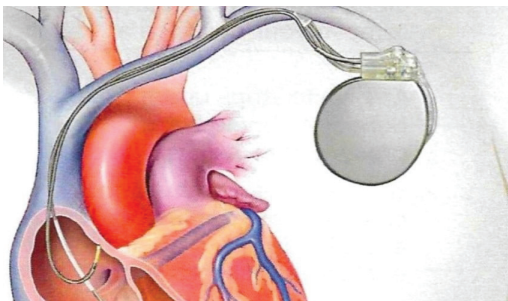

Directives concernant les activités

- ☐ Bras gauche seulement ☐ Bras droit seulement

- À moins d'indication contraire, ne soulevez, ne poussez et ne tirez rien de plus de 10 lb pendant 6 semaines après l'intervention afin de favoriser la cicatrisation autour des sondes.
- Ne levez pas le bras au-dessus de la tête pendant 6 semaines.
- Après 6 semaines, vous pouvez reprendre vos activités normales.

Votre rendez-vous de suivi

- Vous aurez votre premier rendez-vous de suivi de 8 à 12 semaines après l'implantation. Par la suite, nous vous verrons habituellement environ tous les 6 à 12 mois.
- Apportez une liste des médicaments que vous prenez.
- Du personnel infirmier vérifiera votre dispositif. Il effectuera les tests habituels et passera les données en revue.
- On vous dirigera vers un médecin seulement s'il y a des préoccupations.
- Si vous le souhaitez, nous enverrons une copie des résultats à votre médecin de famille, infirmière praticienne ou cardiologue.

Prendre soin de votre incision

Laissez le pansement blanc en place pendant 3 jours (72 heures) après l'intervention.

Retirez-le le _____.

Ne prenez pas de douche et ne mouillez pas le pansement avant cette date.

S'il y a lieu, gardez les bandelettes adhésives ou le ruban sous le pansement blanc en place pendant 1 semaine (7 jours) après l'intervention.

Retirez-les le _____.

Si on a utilisé de la colle pour la peau sur l'incision, ne touchez pas à la colle; elle partira avec le temps.

Tous les points de suture sont résorbables. Ne touchez pas à l'incision; n'y appliquez pas de crème ni d'onguent.

Il est normal d'avoir des bleus.

Utilisez un savon doux et séchez la peau en la tapotant.

La région sera douloureuse jusqu'à une semaine après l'intervention; le meilleur moyen d'y remédier est de prendre du Tylenol ordinaire (ou ce que vous prenez habituellement pour maîtriser la douleur).

Si vous ressentez des secousses ou des soubresauts dans l'abdomen, ce n'est pas une urgence, mais appelez-nous tout de même.

L'incision ne devrait pas s'ouvrir, suinter ou saigner. Si cela se produit, appelez-nous immédiatement.

FAQ

Qu'arrive-t-il lorsque la pile s'affaiblit?

L'affaiblissement de la pile n'a aucune incidence sur le fonctionnement du dispositif. Lorsqu'il lui restera moins d'un an de vie, notre personnel vous conseillera d'augmenter la fréquence de vos rendez-vous de suivi. Il vous préparera ensuite au remplacement du dispositif.

Qu'arrive-t-il si je déménage dans un autre pays ou dans une autre province?

Informez-en notre personnel. C'est à vous de trouver un autre service de gestion du rythme cardiaque qui accepte de nouveaux patients. Nous lui enverrons les renseignements sur votre dispositif.

Est-ce que le dispositif peut mal fonctionner?

Il est très rare qu'un dispositif fonctionne mal. Même lorsque la pile commence à s'affaiblir, le dispositif continue de fonctionner normalement.

Est-ce qu'un aimant peut désactiver le dispositif?

La présence d'un aimant à proximité du dispositif peut modifier le mode ou désactiver certaines fonctions, ce qui pourrait ne pas vous convenir. Dès qu'on éloigne l'aimant, les paramètres habituels se rétablissent.

Puis-je voyager?

Oui. Assurez-vous d'avoir votre carte de porteur d'appareil. Montrez-la au personnel de la sécurité à l'aéroport.